

TRATAMIENTO ELÉCTRICO DE UNA INFECCIÓN DE GARGANTA

ADVERTENCIA: Antes de leer cualquiera de los tratamientos debe conocer acerca del TENS(Transcutaneous **E**lectrical **N**euro **S**timulator) y sus características: ajuste de parámetros, costo, lugares de compra, etc., pues es el aparato generador de las señales eléctricas que se usa para curar todas las enfermedades mostradas en este sitio; es lo equivalente a la medicina. Una descripción del mismo se da en la información denominada : “ TENS CARACTERÍSTICAS “, en este mismo sitio.

Lo importante, como señalé en otros reportes de tratamiento de infecciones, es colocar al agente infeccioso en el paso de la corriente y ésta hará el resto con una efectividad del 100%. Desafortunadamente la corriente no puede penetrar completamente a los senos paranasales y eliminar de ahí la bacteria, debido a lo cual se debe complementar con el antibiótico descrito por su médico.

PROCESO DE TRATAMIENTO

El tratamiento se diseña para que la corriente limpie de bacterias toda la vía respiratoria alta.

PRECAUCIÓN IMPORTANTE.

Cuando se dé el tratamiento se debe mantener siempre las siguientes instrucciones:

- a. Cubrir bocas en la paciente y el tratante.***
- b. Dar un par de kleenex a la paciente y solicitarle que por favor si siente que va a estornudar se ponga los kleenex en la boca para evitar la dispersión de la bacteria.***

c. Iniciar el tratamiento con los pads en el cuello antes que en las fosas nasales , ya que éstas son las que provocan el estornudo por la irritación que trae el paciente, y la que le provoca el paso de la corriente.

ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA.

I. Estimulación de garganta con ambos pads en las anginas o amígdalas(figura 1) .

Con este diseño la garganta se ve atravesada por miles de líneas de corriente que van de un pad al otro, en ambos lados de ella, en la parte superior e inferior.

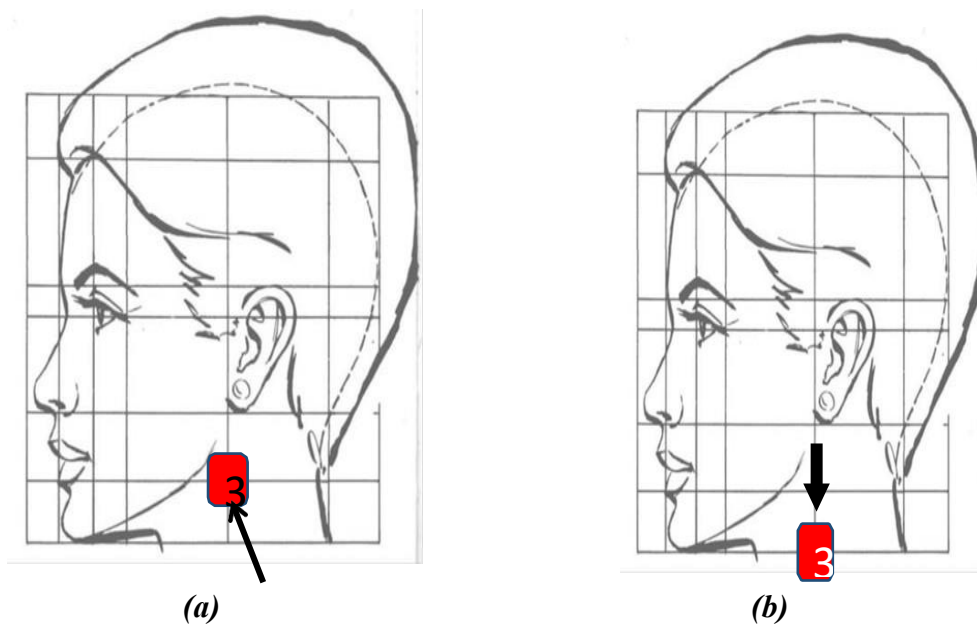


Figura 1(a). Estimulación de la parte superior de la garganta o amígdalas; (b) Tratamiento de parte inferior de garganta o laringe.

PARÁMETROS DEL TRATAMIENTO

Tiempo de estimulación: 5 minutos por posición

Intensidad de corriente : 1 ma(mili amperio o milésima parte de un amperio)o, incrementar la intensidad hasta percibirla, y bajar esta muy ligeramente hasta que desaparezca su percepción; en esta posición estará recibiendo entre 0.7 a 0.9 ma, suficientes para eliminar cualquier tipo de virus o bacteria

Frecuencia de tratamiento : 150 hertz ,o ciclos por segundo que envía el TENS (la máxima que genera un TENS)

II. Tratamiento de ambas fosas nasales, orofaringe o parte posterior de la garganta, faringe y laringe .

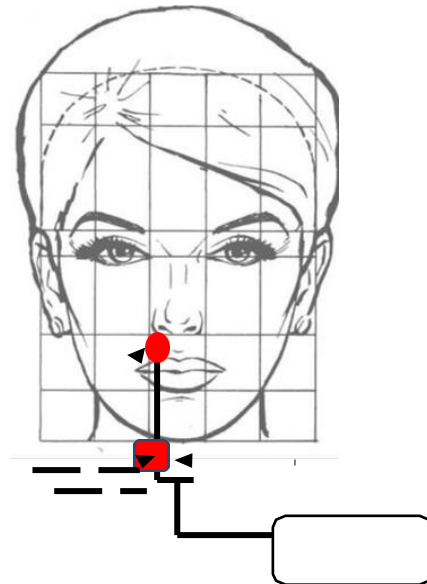


Figura 2. Estimulación de una fosa nasal . La estimulación de la otra fosa nasal es igualal de la primera.

III. Tratamiento de Senos frontales

El tratamiento de esta parte debe hacerse reduciendo a menos de la mitad la intensidad de corriente aplicada antes pues ésta pasará cerca de los nervios oftálmico y auditivos; usar sólo la mitad del tiempo, o sea sólo 2 a 3 minutos por fosa.

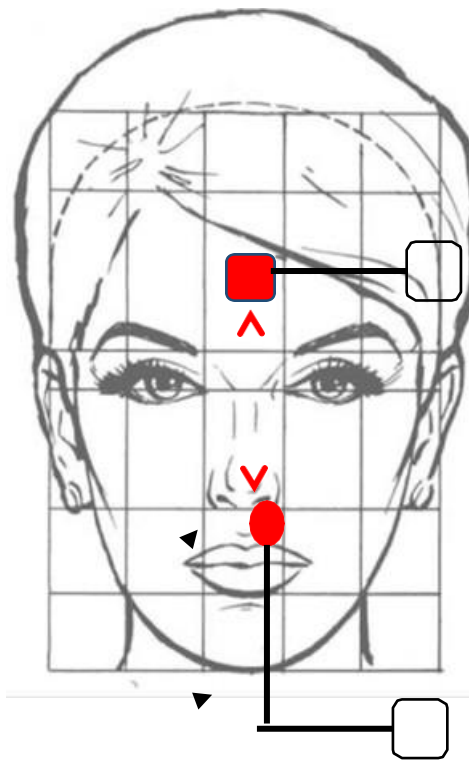


Figura 3. Estimulación de los senos frontales .

PARÁMEROS DEL TRATAMIENTO

Tiempo de estimulación: 2 a 3 minutos

Intensidad de corriente : 1 ma o, incrementar la intensidad hasta percibirla, y bajar esta muy ligeramente hasta que desaparezca su percepción.

Frecuencia de tratamiento 150 hertz .

IV. Tratamiento de Boca y Garganta.

Esta es la última fase del tratamiento, completa en su mayor parte la desinfección de las vías respiratorias altas. La colocación del pad en lengua o fosa nasal no causa mayor dolor que en cualquier otra parte de la piel, por lo cual no debe tenerse temor alguno, además de que todas las técnicas han sido probadas múltiples veces. El pad se coloca de forma tal que la lengua quede en medio de la parte oscura de éste ; se logra doblando éste último para cubrir parte de la punta de la lengua sin tocar con la parte negra los labios o dientes. Un vez en esta posición se aprieta ligeramente con los labios o dientes el pad para favorecer el contacto y paso de la corriente; ésta irá por la lengua y partes energizadas de la boca, laringe, faringe y base del cuello, para salir al pad colocado en esta posición.

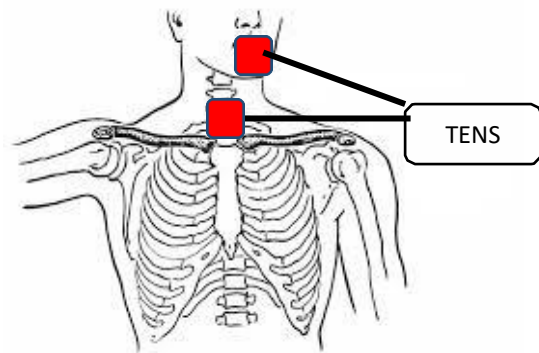
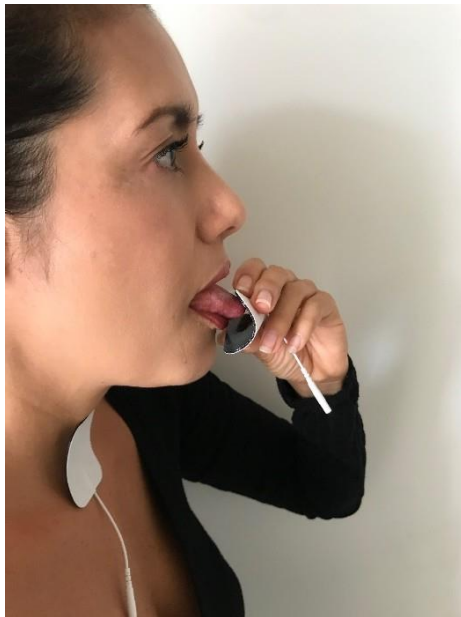


Figura 4. Estimulación de la boca .

PARÁMETROS DEL TRATAMIENTO

Tiempo de estimulación: 5 minutos

Intensidad de corriente : 1 ma o, incrementar la intensidad hasta percibirla, y bajar ésta muy ligeramente, hasta que desaparezca su percepción.

Frecuencia de tratamiento : 150 hertz

Tratamiento de parte del oído interno.

Esta posición ayuda sólo cuando se inicia una infección de los oídos, éstos duelen y/o se pierde audición; un pad se enrolla dejando la parte negra hacia afuera, úsese pads redondos pequeños de 1.5 o 2.0 centímetros de diámetro; el otro pad va en la angina del cuello.

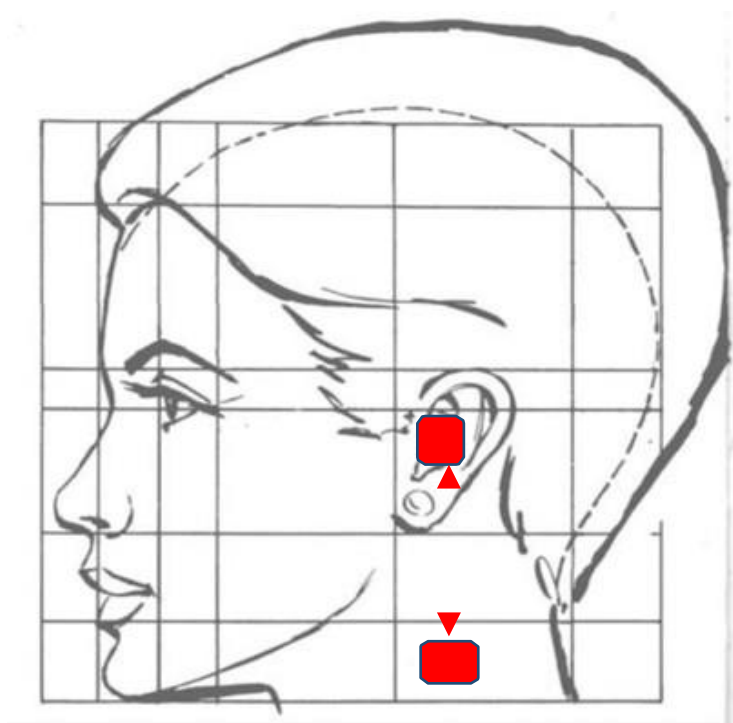


Figura 5. Estimulación del oído izquierdo.

PARÁMETROS DEL TRATAMIENTO

Tiempo de estimulación: 5 minutos

Intensidad de corriente : 1 ma o, incrementar la intensidad hasta percibirla, y bajar esta hasta que desaparezca su percepción.

Frecuencia de tratamiento : 150 h