

VIH - En proceso de validación

ADVERTENCIA: Antes de leer cualquiera de los tratamientos debe conocer acerca del TENS(Transcutaneous **E**lectrical **N**euro **S**timulator) y sus características: ajuste de parámetros, costo, lugares de compra, etc., pues es el aparato generador de las señales eléctricas que se usa para curar todas las enfermedades mostradas en este sitio; es lo equivalente a la medicina. Una descripción del mismo se da en la información denominada : “ TENS CARACTERÍSTICAS “, en este mismo sitio.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRATAMIENTO

El tratamiento requiere de dos fases, iniciando con un tratamiento de 30 minutos de vapor con objeto de sacar los virus del interior de los linfocitos T que los contienen y cuya efectividad está entre 60 y 70%; y posteriormente viene la fase de tratamiento hidro eléctrico con objeto de barrer todo el sistema circulatorio que contiene a los virus del VIH previamente liberados en la primera fase y destruirlos penetrando al interior de ellos; esta fase tiene una efectividad del 100%

FASE I . Aplicación de una sesión de vapor por un tiempo de 30 minutos. En esta se debe tener una pequeña toalla para secar el cuerpo un par de veces durante la sesión de vapor; la persona debe tener lista unas sandalias y la cámara de vapor con un asiento . Este producto se puede adquirir fácilmente por medio de internet en algún sitio seguro para realizar la compra, como podría ser www.mercadolibre.com y recibirlo en su propia casa..



Figura 1. Imagen de una cámara de vapor

PRIMER DÍA

FASE II. TRATAMIENTO HIDROELÉCTRICO .

Esta fase se aplica inmediatamente después del tratamiento de calor; en ésta el virus es eliminado por medio de una corriente eléctrica que los atraviesa , destruye sus partes internas y hace explotar su membrana externa. **Si** la corriente alcanza al virus su efectividad es del 100% siendo una técnica sumamente efectiva, pero también depende de la correspondiente al tratamiento de vapor, el cual sólo es 60 a 70 % efectivo en su fin de sacar a los virus del interior de las células que lo protegen.

Para esta parte se debe contar con una tina resistente de plástico, el cual es un material aislante y encierra el proceso del exterior evitando fugas de corriente; debe soportar el peso del agua y la persona, para evitar accidentes la tina “siempre” debe instalarse en el baño, bajo la regadera. Por otra parte, el TENS usa una pila de 9 volts que muy difícilmente podría hacer un daño grave a la persona, el tratamiento eléctrico no está conectado a la fuente de alimentación eléctrica de la casa. Lo importante en el tratamiento es realizarlo de forma totalmente segura, tanto para la persona infectada como para los familiares que lo aplican; por tanto se deben tener las siguientes condiciones:



Figura 2. Imagen de una tina de plástico indicada para el tratamiento hidro eléctrico.

PRECAUCIONES:

- a. Usar una tina de plástico como las mostradas en la figura 5, bien sea para una cobertura de cuerpo completo; sus medidas aproximadas para la primera son: 50 cm de ancho por 90 cm de largo y 50 de altura.*
- b. No debe usarse la tina construida con la casa que está en la regadera, ya que en tales casos la corriente se va del agua hacia la tierra que se tiene en la salida de drenaje o la entrada del agua y pasa poco por el cuerpo sin eliminar al virus.*
- c. Tampoco debe colocarse la tina en la sala o recámara, ya que siempre existe la posibilidad de que la tina se rompa o se derrame de la tina llegando a contactos conectados a la energía eléctrica de la casa pudiendo electrocutar a todos los que estén en contacto con el agua:*

“ La tina debe colocarse en el baño “

- c. Las zonas de la rodilla en donde se colocarán los pads deben de estar totalmente secas, así se evita que la corriente vaya del agua de la tina hacia el polo opuesto por medio de la piel mojada y no penetre al cuerpo como se deseaba.*
- d. Si la persona usa un marcapasos o tiene alguna afectación cardíaca NO DEBE SOMETERSE A ESTE TIPO DE TRATAMIENTO, o consultar con su médico .*

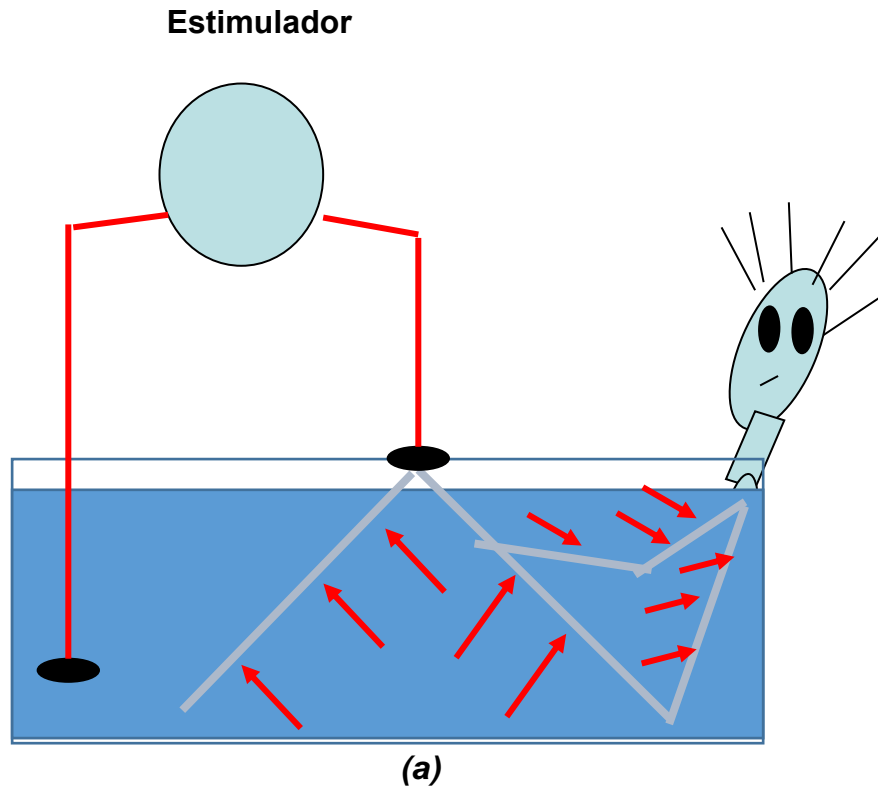


Figura 3. Tratamiento hidroeléctrico de cuerpo completo; (b) Tratamiento de abdomen y tórax , piernas fuera del agua. La corriente penetra por cada punto de la piel conducida por el agua hasta llegar a los otros pads en las rodillas, que están fuera del agua.

Posición de los electrodos.

- **El electrodo positivo(punta roja) se sumerge en el interior del agua sin pad conectado a él.**
- **Los otros dos electrodos de 5 x 10 centímetros , ambos con la misma polaridad, se pegan uno en cada una de las rodillas que están fuera del agua; ambas rodillas y su alrededor deben estar completamente secos para evitar que la corriente se desvíe y no penetre al cuerpo.**

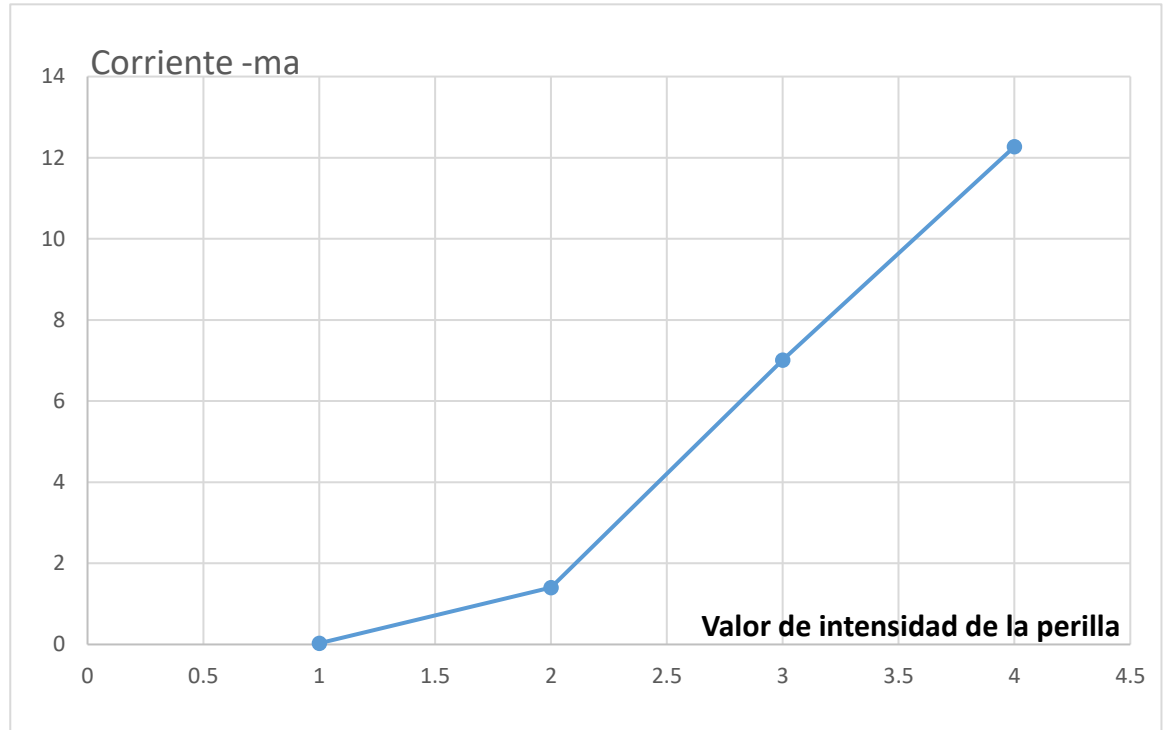


Figura 4. Relación entre valor de la perilla de intensidad “de mi TENS” y la corriente producida en la tina de agua. Nivel 4 en la perilla del TENS, que produce una corriente de 12 ma, es la recomendada.

INTENSIDAD DE CORRIENTE. – Incrementar la intensidad de corriente con la perilla del TENS hasta llegar al nivel 4, si lo soporta sin dolor, y usar esa intensidad a lo largo del tratamiento.

¿ Como dar la misma polaridad a dos pads? a figura 6 muestra como energizar dos pads con la misma polaridad, la técnica es muy simple pero es recomendable tener un cable del tipo punta de caimán para facilitar la conexión, el cual se vende en cualquier tienda de artículos electrónicos. La figura muestra como pelar un trozo de cable tanto en las extremidades que entrarán en las terminales de ambos pads, como en la parte central que irá a una de las polaridades del TENS.

Una vez que las terminales entran en la terminal del pad se deben apretar fuertemente por medio de una pinzas para que no se zafen y el contacto sea seguro.

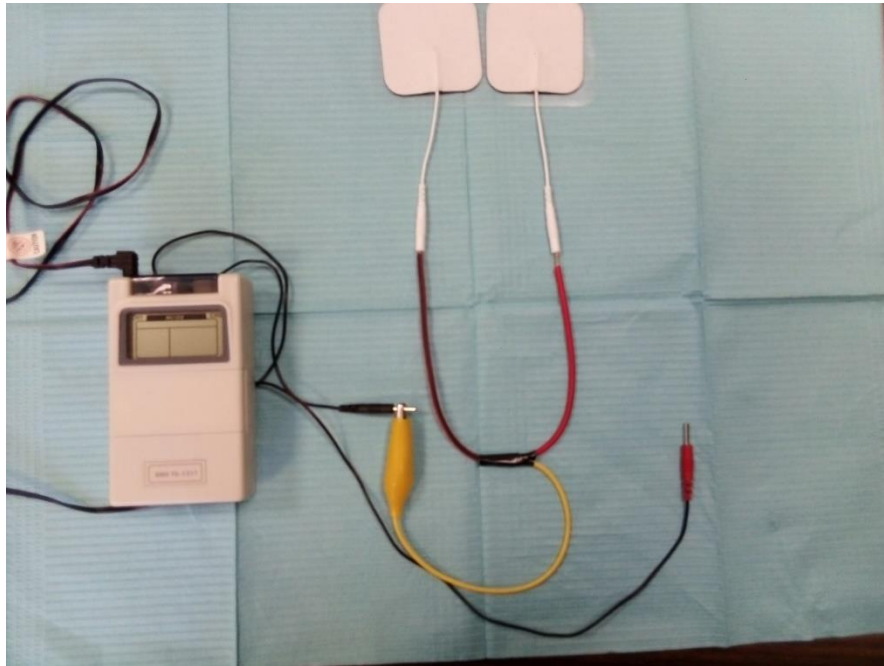


Figura 5. Conexión de dos pads a una misma polaridad.

Intensidad de corriente. Según los datos obtenidos en mi mismo se debe aplicar una intensidad de corriente aproximadamente de 10 a 12 ma (miliamperios) la cual se logra en un TENS del tipo 7000 cuando la perilla esta entre el número 3 y el 4, como se observa en la figura 7. La intensidad de corriente es fuerte, se siente en las rodillas de ambas piernas .

FASE IV. TIEMPO DE TRATAMIENTO.

Este debe ser de 20 minutos para garantizar que la corriente a barrido todo el flujo sanguíneo con tiempo suficiente para mantener la corriente constante en cada virus y poder eliminarlo con una efectividad del 100% .

Es recomendable volver aplicar el tratamiento a la semana siguiente por si acaso sobrevivió parte de los virus y no fueron eliminados durante el proceso o por el sistema inmune.

El resultado final debe ser verificado con análisis de laboratorio que mida la carga viral que da la cantidad de virus , si estos aún existen, y del conteo de linfocitos T, los cuales deberán comenzar a crecer nuevamente si ya no existe el virus que los destruye y a cuidar nuestro cuerpo de nuevas invasiones de agentes dañinos.

SEGUNDO DÍA – TRATAMIENTO ANTI BACTERIANO.

- Las investigaciones actuales señalan la complicidad entre un grupo de bacterias que facilitan el paso del virus del VIH al torrente sanguíneo y viceversa de regreso al intestino. Las infecciones graves que se producen principalmente en las personas con un sistema inmunitario debilitado (llamado infecciones oportunistas), son: incluyendo infecciones fúngicas (como [cryptococcosis](#) y [Pneumocystis jirovecii pneumonia](#)), infecciones bacterianas (como [Mycobacterium avium complex](#) y [Mycobacterium tuberculosis](#)) y infecciones virales (como infecciones graves por [herpes simplex](#) y [cytomegalovirus](#)): ref.: <https://www.msmanuals.com/es-mx/hogar/infecciones/infecci%C3%B3n-por-el-virus-de-la-inmunodeficiencia-humana-vih/infecci%C3%B3n-por-el-virus-de-la-inmunodeficiencia-humana-vih>, consultada el día : 16/9/2024 .
- El fin del tratamiento en el segundo día es la eliminación de este grupo de microbios a la vez que se restauran las lesiones intestinales que producen un sangrado intestinal, el cual no se hizo debido a la poca intensidad enviada al intestino con el fin de eliminar el VIH.

TRATAMIENTO INTESTINAL

- a. Colocar un par de pads horizontalmente en ambos lados del abdomen con objeto de barrer todo el intestino, por ejemplo, con las dos posiciones mostradas en la figura 6; primero 10 minutos colocando los pads en la posición 1, y luego otros 10 minutos usando la posición 2.

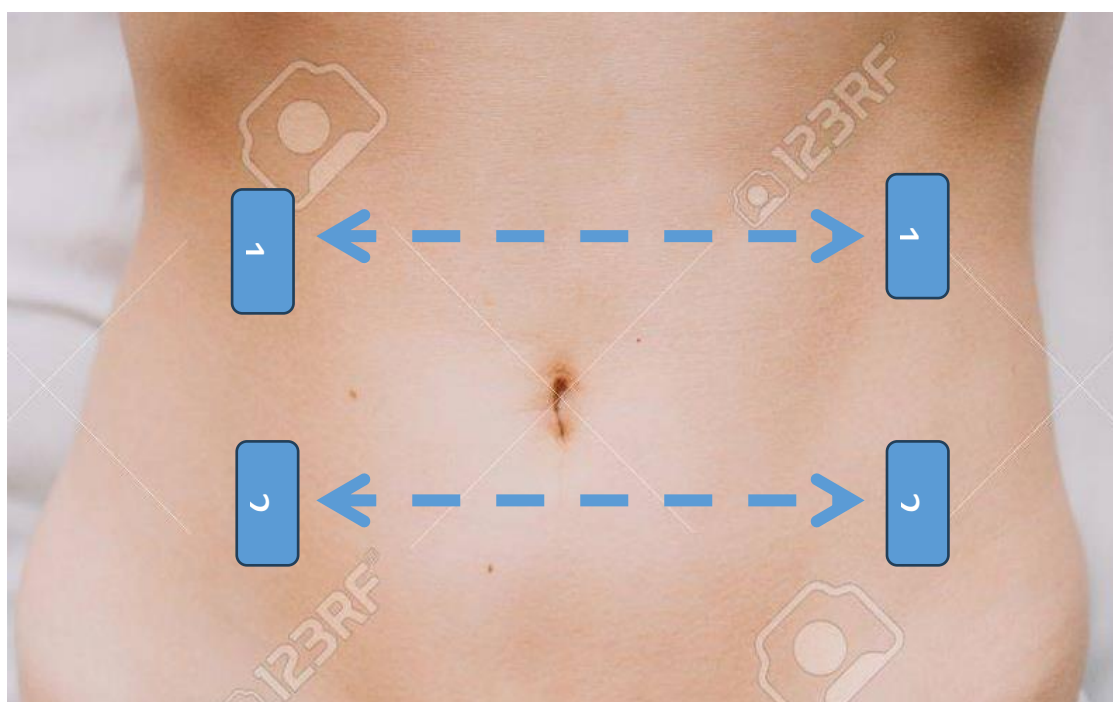


Figura 6. Estimulación horizontal del intestino .

- b. Colocar un pad de 5 x 10 ó 5 x 5 cm en el ano ,y el otro en cada una de las tres posiciones mostradas en la figura 7, estimulando 5 minutos en cada una de ellas; primero entre la posición 0 y la 1; luego entre la 0 y la 2, y finalmente entre la 0 y la 3. Una vez terminado deshechar el pad del ano pegándolo en un kleenex doble y luego en una bolsa de plástico; el otro pad aún podría usarse si se desea.

INTENSIDAD DE CORRIENTE: Incrementar suavemente ésta, hasta sentir la presencia de ella y dejar en esa intensidad.

1

