

TRATAMIENTO ELÉCTRICO DE UNA INFECCIÓN DE GARGANTA

ADVERTENCIA: Antes de leer cualquiera de los tratamientos debe conocer acerca del TENS(Transcutaneous **E**lectrical **N**euro **S**timulator) y sus características: ajuste de parámetros, costo, lugares de compra, etc., pues es el aparato generador de las señales eléctricas que se usa para curar todas las enfermedades mostradas en este sitio; es lo equivalente a la medicina. Una descripción del mismo se da en la información denominada : “ TENS CARACTERÍSTICAS “, en este mismo sitio.

Lo importante, como señalé en otros reportes de tratamiento de infecciones, es colocar al agente infeccioso en el paso de la corriente y ésta hará el resto con una efectividad del 100%. Desafortunadamente la corriente no puede penetrar completamente a los senos paranasales y eliminar de ahí la bacteria, debido a lo cual se podría complementar con el antibiótico descrito por su médico si la infección continuara.

PROCESO DE TRATAMIENTO

El tratamiento se diseña para que la corriente limpie de bacterias toda la vía respiratoria alta.

PRECAUCIÓN IMPORTANTE.

Cuando se dé el tratamiento se debe mantener siempre las siguientes instrucciones:

- a. Cubrir bocas en la paciente y el tratante.*
- b. Dar un par de kleenex a la paciente y solicitarle que por favor si siente que va a estornudar se ponga los kleenex en la boca para evitar la dispersión de la bacteria.*

ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA.

El tratamiento debe cubrir todas las partes en conexión directa o indirecta con las fosas nasales, esto es, deben tratarse las siguientes partes:

FASE I:

- 1. De fosa nasal izquierda a frente.***
- 2. De fosa nasal izquierda a la base del cuello.***
- 3. De fosa nasal izquierda al interior del oído izquierdo***

FASE II :

- 1. De fosa nasal derecha a frente.***
- 2. De fosa nasal derecha a la base del cuello.***
- 3. De fosa nasal derecha al interior del oído derecho.***

FASE III:

- 1. De la fosa nasal derecha a la lengua.***
- 2. De la fosa nasal izquierda a la lengua.***

FASE IV:

Estimulación entre ambas amígdalas del cuello(anginas) .

TIEMPO DE TRATAMIENTO EN CADA POSICIÓN = 3 MINUTOS .

INTENSIDAD DE CORRIENTE A USAR: Incrementar la intensidad hasta percibirla , sin que lastime, y dejarla en esa posición el tiempo recomendado.

TIPO DE PADS A USAR: Uno redondo de 3 a 3.5 centímetros de diámetro para introducir en la nariz, y dos rectangular de 4 x 4 ó 5 x 5 centímetros, para las otras posiciones.

IMÁGENES ILUSTRATIVAS

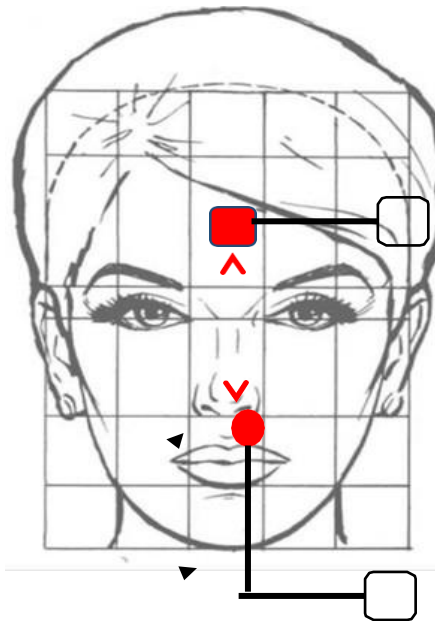


Figura 1. Estimulación de nariz a frente.



Figura 2 . Estimulación de fosa nasal a la base del cuello.

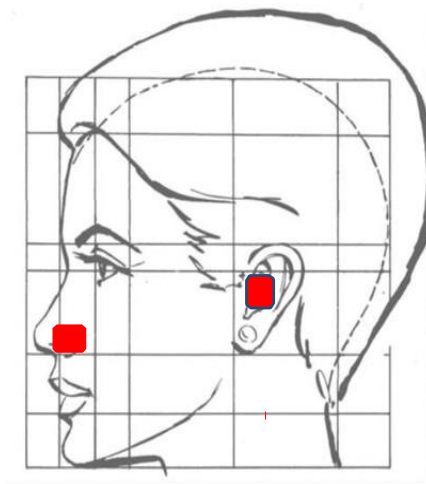


Figura 3 . Estimulación de fosa nasal al oído

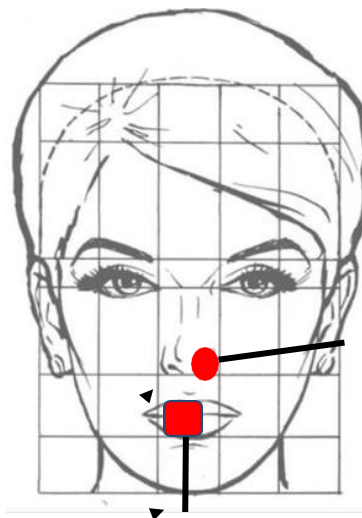


Figura 4 . Estimulación de fosa nasal a la lengua

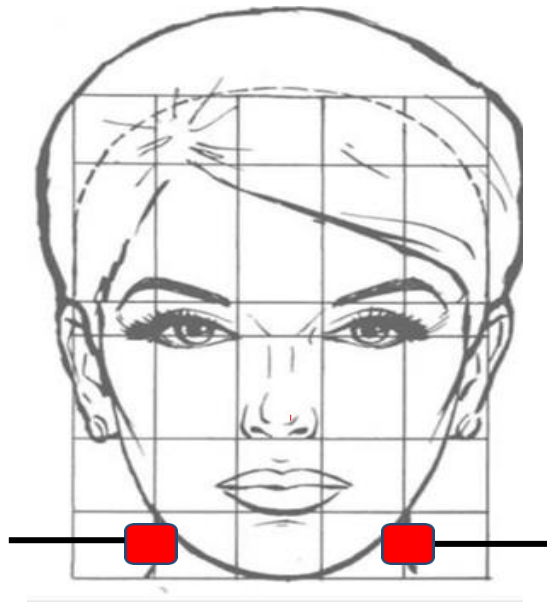


Figura 5. Estimulación entre ambas amígdalas.