


TRATAMIENTO ELÉCTRICO DE LA LEPROA

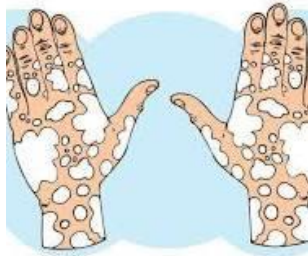

22/1/2025

INTRODUCCIÓN.

La enfermedad de la lepra tiene antecedentes bíblicos, y nuestro Señor Jesucristo curó a 10 leprosos que deambulaban juntos gritándole tuviera compasión de ellos y los curara; hoy día(2025) existen más de 170,000 enfermos en todo el mundo, y para ellos envía este nuevo ramillete en la Canasta Divina. Esta enfermedad es causada por una bacteria denominada *Mycobacterium leprae* la cual ataca el sistema nervioso y la piel, ésta se transmite por contacto directo con una persona enferma tocando su piel o por bien por la nariz al estornudar o hablar con ella. Una de las características o cualidades de la energía eléctrica es comportarse como un antimicrobiano de amplio espectro y, aún cuando ya existe una cura para esta enfermedad por medio del uso de tres medicamentos denominados : dapsona, rifampicina y Iclofazimina, el tratamiento requiere de una duración de 6 meses. No existe en la actualidad medicamento libre de efectos tóxicos, o por lo menos causar dolor estomacal al ingerirlo; sin embargo, la alternativa sería vivir con la enfermedad, o probar el tratamiento eléctrico y curar en tan sólo tres sesiones la enfermedad, o por lo menos reducir sus efectos y acortar el tratamiento actual.

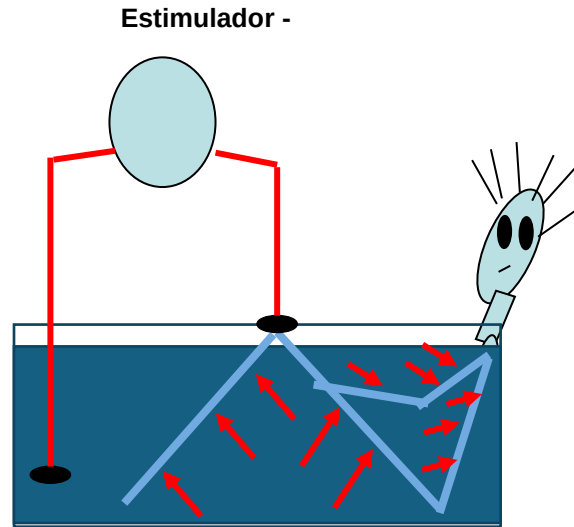


Figura 1. Tratamiento hidroeléctrico

Como la enfermedad es sistémica o generalista, no es factible el uso de pads, excepto, tal vez, en la cara. El tipo de enfermedad requiere de un tratamiento del mismo tipo que ésta, o sea sistémico, integral a todo el cuerpo; uno hidroeléctrico de cuerpo completo , que ya se probó ser totalmente seguro, desde que fue diseñado para el tratamiento del VIH, virus que flota por todo el torrente sanguíneo en el interior de los linfocitos T.

TRATAMIENTO:

Se coloca a la persona parada en medio de una tina de plástico llena a la mitad con agua caliente, pero confortable, con un chorro de vinagre de casa para aumentar la conductividad del agua, y se le pide sentarse lentamente sin sumergir las rodillas, las cuales deberán estar totalmente secas, hasta sumergir todo el cuerpo, incluyendo los hombros, como se muestra en la figura 1. En la parte seca de ambas rodillas se pega un pad rectangular de 5 x 10, ó 4 x 8 centímetros previamente untado con una pomada como la vitacilina o alguna similar, cuyo propósito es reducir la irritación causada por la intensidad de corriente que pasará por ellos, además de rociarlos con agua para reducir la resistencia de la piel en contacto. Ambos pads deberán conectarse a una sólo polaridad, de preferencia la negativa (terminal negra del TENS), usando un cable duplex como el mostrado en la figura 3; por ellos saldrá la corriente proveniente del cuerpo hacia el TENS. La otra terminal (roja) del TENS

se sumergirá al interior de agua en la tina fijándola para que no se salga. Con este tipo de configuración la corriente eléctrica irá del TENS hacia el agua, la cual estará energizada toda ella penetrando en cada punto de la piel hacia el interior del cuerpo, buscando el camino de mínima resistencia hacia la otra polaridad que se halla en cada rodilla, y de ahí regresar al TENS ,cerrando el circuito. De esta manera la corriente recorre desde cada punto de la piel todo el cuerpo destruyendo en su camino la bacteria *Mycobacterium leprae* y curando a la persona de dicha enfermedad . Resta tratar la cara por medio de pads como se muestra a continuación colocándolos de manera lógica, siguiendo un sentido común, de la misma forma que se han diseñado todos los procesos.



Figura 2, Posición de pads en la cara.

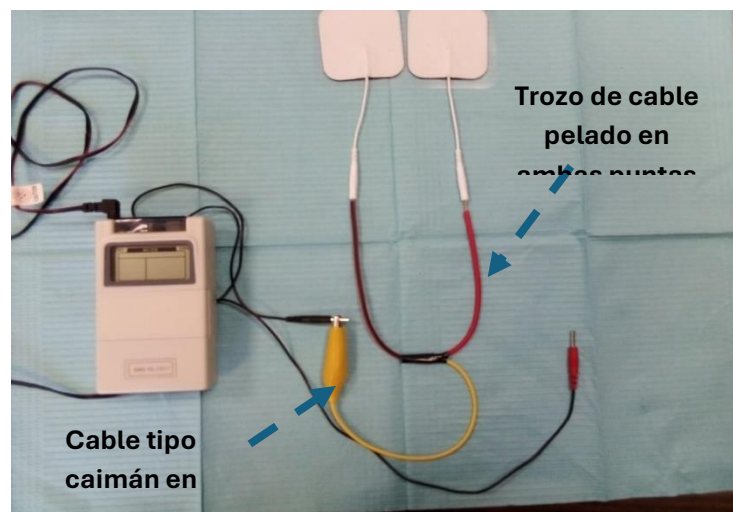


Figura 3. Unión de dos pads a una misma polaridad - Duplex.

Debe tenerse en cuenta que la corriente siempre viaja de un pad al otro y no colocar a los ojos en su trayectoria. La figura 2 muestra algunas de las posiciones posibles para barrer la cara: de (1) a (1); de (2) a (2), etc.

TIEMPOS DE TRATAMIENTO:

HIDROELÉCTRICO – 30 minutos .

FACIAL - 10 minutos por cada posición.

INTENSIDAD DE CORRIENTE :

HIDROELÉCTRICO – 12 ma .

FACIAL - 0.8 a 1.0 ma , dependiendo del dolor causado.

TAMAÑO DE PADS: 4 X 4, ó 5 x 10 cm para el tratamiento hidroeléctrico; y de 4 x 4 ó 5 x 5 cm para el facial.