

TRATAMIENTO DE LAS HEPATITIS VIRALES – A,B,C,D,E,G

PROLOGO. *Este proceso esta aún en fase de prueba, ya que aún cuando esta diseñado usando la lógica de los principios que rigen la aplicación de la energía eléctrica en el cuerpo, ha sido muy difícil obtener pacientes para cada uno de los procesos desde una escuela de ingeniería. Lo peor que puede suceder al probar un proceso es que la técnica no cure la enfermedad, pero es IMPOSIBLE que se lastime o electrocute al paciente con un generador(TENS) que usa una pila de 9 volts; la silla eléctrica aplicaba 2,000 volts.*

ADVERTENCIA: *Antes de leer cualquiera de los tratamientos debe conocer acerca del TENS(Transcutaneous **E**lectrical **N**euro **S**timulator) y sus características: ajuste de parámetros, costo, lugares de compra, etc., pues es el aparato generador de las señales eléctricas que se usa para curar todas las enfermedades mostradas en este sitio; es lo equivalente a la medicina. Una descripción del mismo se da en la información denominada : “ TENS CARACTERÍSTICAS “, en este mismo sitio.*

13/1/2025

La hepatitis viral es una inflamación del hígado causada, entre otros factores, por un virus, y afecta a las personas causando: debilidad, piel y heces amarillas, náuseas, cansancio, orina oscura, ...; **¡Si no se guarda reposo podría ser mortal** ¡ El lector que ha seguido algunos tratamientos eléctricos notará fácilmente la razón de diseñar uno para esta enfermedad; ya que ésta la causan virus, y la corriente eléctrica es un anti viral de amplio espectro que ha eliminado a los tres tipos de virus del herpes, y a todos los virus patógenos del papiloma, con una efectividad del 100% en un solo tratamiento. Un aspecto importante en este caso es que el mismo tratamiento PUEDE ELIMINAR CUALQUIERA DE LOS VIRUS SEÑALADOS

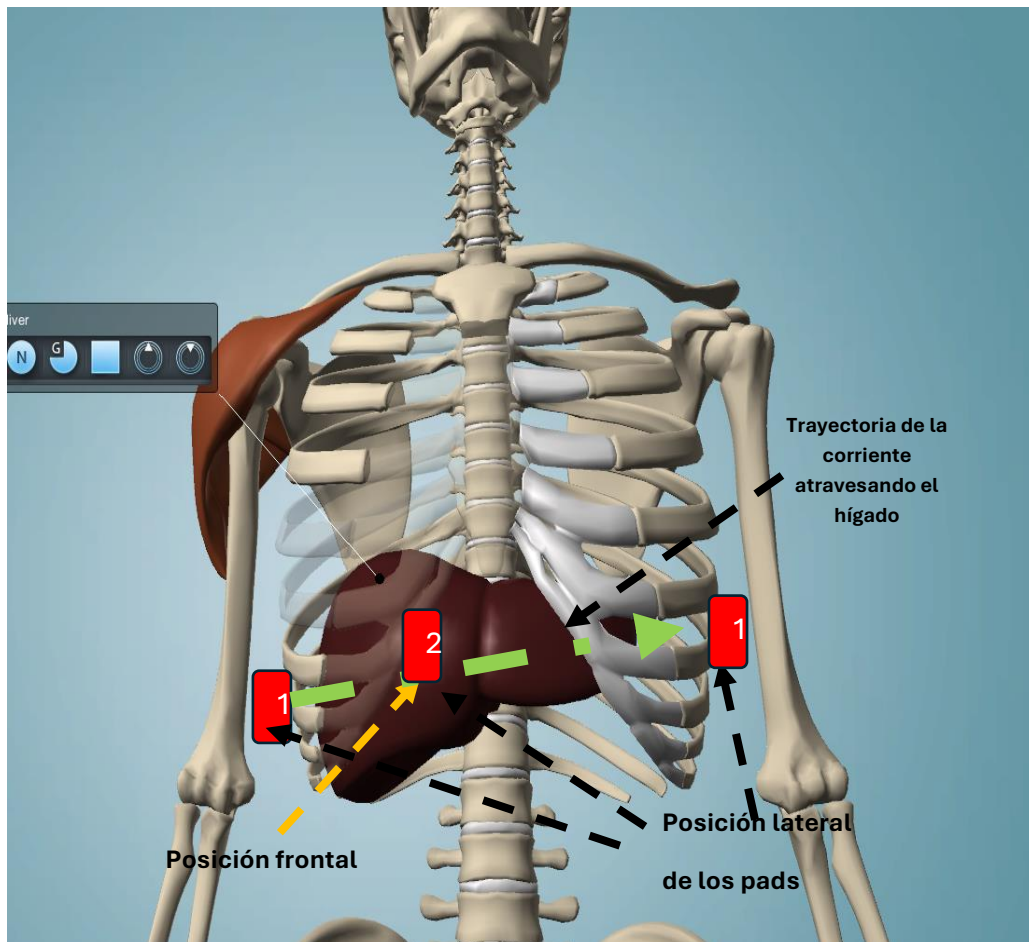


Figura 1. Posición del hígado en el cuerpo, así como la de los pads correspondientes para atravesar éste en forma longitudinal colocando pads en ambos lados de las costillas, y pads al frente y en la espalda para cruzar éste frontalmente(2).

A semejanza de procesos anteriores el tratamiento se enfoca en atravesar el órgano enfermo con objeto de alcanzar al virus y, debido a la baja impedancia o resistencia

a la penetración de la corriente en el cuerpo de éstos, se penetran calentando sus órganos destruyéndolos y, tal vez, haciendo explotar su membrana externa como si fuera una olla exprés al aumentar el volumen del líquido en su cuerpo.

FASE I . Aplicación de una sesión de vapor por un tiempo de 30 minutos. La función de esta fase de calor es provocar la salida de los virus de las células del hígado y así poder penetrarlas por medio de la corriente eléctrica. En esta parte se debe tener una pequeña toalla para secar el cuerpo un par de veces durante la sesión de vapor; la persona debe tener lista unas sandalias y la cámara de vapor con un asiento . Este producto se puede adquirir fácilmente por medio de internet en algún sitio seguro para realizar la compra, como podría ser



www.mercadolibre.com o AMAZON y recibirlo en su propia casa..

Figura 2. Imagen de una cámara de vapor

FASE II. TRATAMIENTO ELÉCTRICO

INTENSIDAD DE CORRIENTE. Como en todos los casos, y a fin de evitar el uso de un multímetro, se debe ir incrementando suavemente la intensidad hasta que la persona la sienta o perciba y dejarla en esa intensidad durante todo el tiempo del tratamiento .

Tiempo de tratamiento. Tratar 15 minutos en cada posición.

Fases:

1. Aplicar una fase de calor durante 30 minutos con objeto de impulsar la salida de los virus del interior de las células del hígado(ver figura 2) e inmediatamente pasar a la mesa de exploración o cama para aplicar el tratamiento eléctrico.
2. Colocar un par de pads rectangulares en ambos lados de cuerpo, como se indica en la posición (1) figura 1, con objeto de atravesar el hígado horizontalmente, y estimular así durante 15 minutos.
3. Colocar los pads(2), uno al frente en el abdomen, como se muestra en la figura 1, y el otro en la posición opuesta en la espalda, y estimular así durante 15 minutos .
4. Repetir el mismo tratamiento al tercer día con objeto de eliminar posibles virus sobrevivientes al primero .

Tamaño de los pads: Usar pads de 4 x 8 ó 5 x 10 cm.

Tiempo de estimulación eléctrica : 15 minutos por posición.