

LEUCEMIA

PROLOGO. *Este proceso esta aún en fase de prueba, ya que aún cuando esta diseñado usando la lógica de los principios que rigen la aplicación de la energía eléctrica en el cuerpo, ha sido muy difícil obtener pacientes para cada uno de los procesos desde una escuela de ingeniería. Lo peor que puede suceder al probar un proceso es que la técnica no cure la enfermedad, pero es IMPOSIBLE que se lastime o electrocute al paciente con un generador(TENS) que usa una pila de 9 volts; la silla eléctrica aplicaba 2,000 volts.*

ADVERTENCIA: *Antes de leer cualquiera de los tratamientos debe conocer acerca del TENS(Transcutaneous **E**lectrical **N**euro **S**timulator) y sus características: ajuste de parámetros, costo, lugares de compra, etc., pues es el aparato generador de las señales eléctricas que se usa para curar todas las enfermedades mostradas en este sitio; es lo equivalente a la medicina. Una descripción del mismo se da en la información denominada : “ TENS CARACTERÍSTICAS “, en este mismo sitio.*


26/9/2024

ADVERTENCIA: *Antes de leer cualquiera de los tratamientos debe conocer acerca del TENS(Transcutaneous **E**lectrical **N**euro **S**timulator) y sus características: ajuste de parámetros, costo, lugares de compra, etc., pues es el aparato generador de las señales eléctricas que se usa para curar todas las enfermedades mostradas en este sitio; es lo equivalente a la medicina. Una descripción del mismo se da en la información denominada : “ TENS CARACTERÍSTICAS “, en este mismo sitio.*


RESUMEN

Este proceso tiene como fin esencial el tratamiento de la médula ósea en la cual se generan las células malignas con objeto de recuperar su funcionamiento normal y generar sólo glóbulos blancos o células sanguíneas sanas, las cuales, espero ,podrían destruir a las malignas terminando así la cura de la persona. Pero continuo trabajando para investigar como destruir las células blancas malignas del torrente sanguíneo. **El tratamiento es de tres días.**

FASE I. Estimulación de la médula en los huesos de la cadera y fémur usando pads - 20 minutos

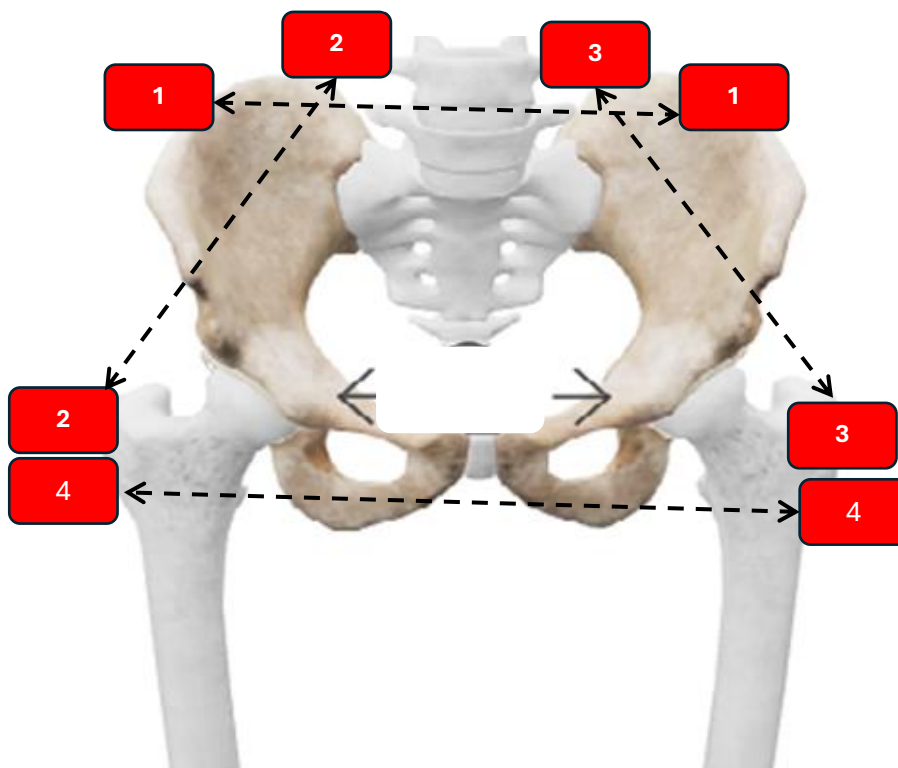

(a)

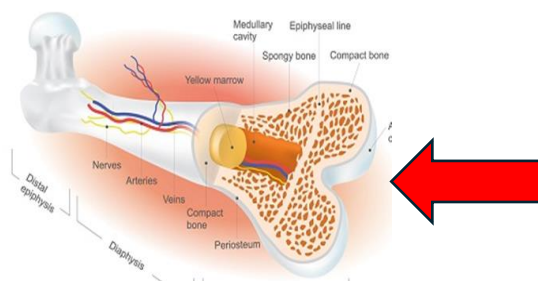

(b)

Figura 1. Tratamiento de la médula ósea de la cadera

Estimulación :

- a. Pads en ambos lados de la cadera, posición 1. – Tiempo de estimulación = 5 minutos.*
- b. Pads entre parte trasera de la cadera y cabeza del fémur; posiciones 2 y 3 – Tiempo de estimulación = 5 minutos por posición.*
- c. Pads entre cabeza de ambos fémurs, pads (4) . Tiempo de estimulación = 5 minutos por posición.*

INTENSIDAD DE CORRIENTE: De manera similar en todos los procedimientos, ir aumentando la intensidad de corriente hasta percibirla, bajar muy ligeramente ésta hasta dejar de sentirla ; tratar en esa posición o intensidad el tiempo recomendado.

SEGUNDA FASE– TRATAMIENTO HIDRO ELÉCTRICO – 20 minutos .

El tratamiento hidro eléctrico es uno de carácter sistémico, integral a todas las partes que toca el agua la cual se convierte en un pad a la medida de la parte del cuerpo que está sumergida. Así, de cada punto de la piel sale o entra una línea de corriente que viaja hacia los pads colocados en ambas rodillas barriendo todo el cuerpo sumergido, se hace de esta manera a fin de reducir la cantidad de corriente por un pad, y se divide el total de corriente que irriga el cuerpo en dos partes; conviene que estos pads sean de forma rectangular de 5 x 10 cm , o algo similar .

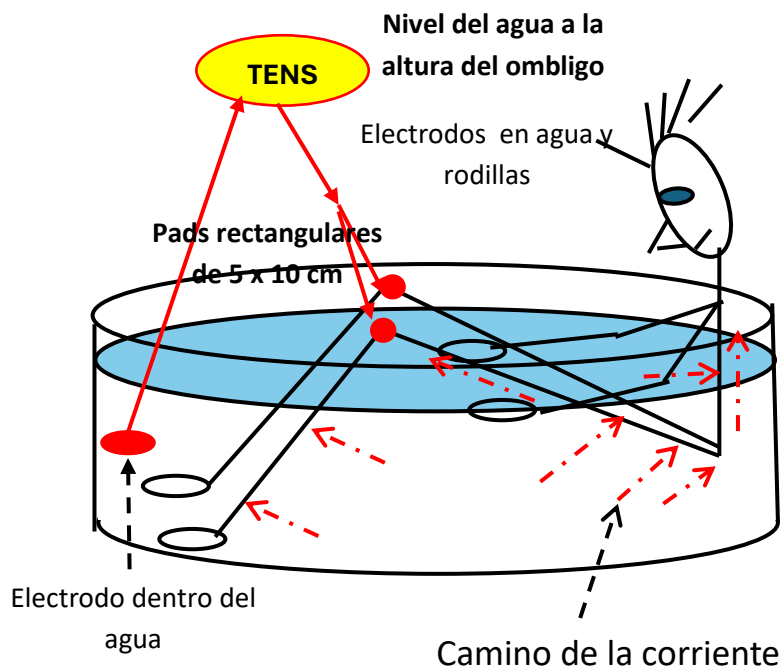


Figura 2. Tratamiento hidro eléctrico de medio cuerpo.

PREPARACIÓN.

- Colocar una tina de plástico de tamaño suficiente como para dar un baño de asiento en el baño o regadera de su casa a fin de evitar accidentes.
- Llenarla con agua caliente, pero confortable, a fin de que ésta cubra hasta el ombligo, una vez sentada la persona.
- Agregar un chorrito de vinagre a fin de aumentar la conductividad del agua.
- Introducir a la persona parándose sobre el agua, e irse sentando doblando las rodillas y cuidando de no sumergirlas, a fin de que estén secas, lo mismo que su alrededor. No introducir los brazos al interior del agua.
- Colocar los pads rectangulares en la rodilla, unidos por un cable a la misma polaridad, y conectarlos a una polaridad del TENS; la otra punta del TENS debe sumergirse al interior del agua sin colocar pad alguno en él.
-

TRATAMIENTO

- a. Encender el TENS e incrementar la intensidad de corriente hasta percibirla, pero sin lastimar las rodillas, y dejarla en esa posición durante 20 minutos.
- b. Apagar el TENS , desconectar los pads y ayudar a la persona a salir y secarse.

CREACIÓN DE UN CABLE PARA CONECTAR DOS PADS A UNA SOLA POLARIDAD

La construcción es muy sencilla y el tratamiento creará dos cables similares al cual llamaremos “**Duplex**” elaborados siguiendo los pasos a continuación:

1. Conseguir un trozo de cable y pelarlo en ambas extremidades y al centro del mismo como se muestra en la imagen 3.
2. Introducir cada extremo en la entrada de ambos pads y sujetar fuertemente oprimiendo con una pinzas.
3. Conseguir un cable tipo caimán en cualquier tienda de equipo electrónico y conectar un extremo al centro del cable.
4. Unir la otra boca o extremo del cable caimán con una punta del TENS como se muestra ven la figura 3; con eso se consigue dar la misma polaridad a ambos pads – **Duplex**, los cuales se conectan a la rodilla.

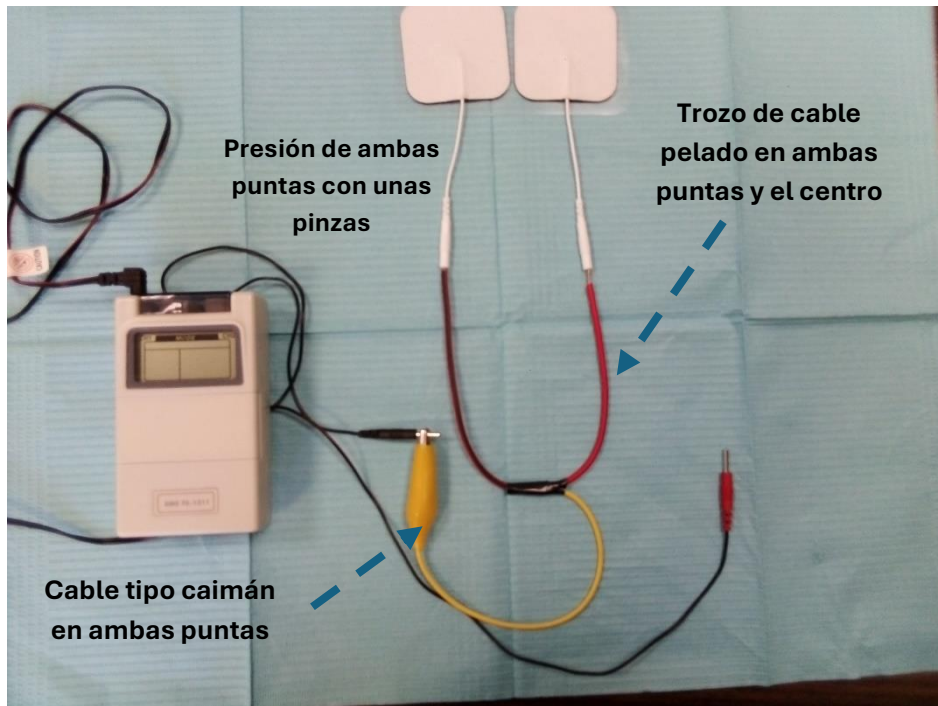


Figura 3. Unión de dos pads a una misma polaridad (Duplex).