

TRATAMIENTO ELÉCTRICO DE LA DIABETES -

2

15/5/2025

PROLOGO. *Este proceso está aún en fase de prueba, ya que aún cuando tiene una alta probabilidad de éxito pues se ha diseñado usando la lógica de los principios que rigen la aplicación de la energía eléctrica en el cuerpo, ha sido muy difícil obtener pacientes para observar cada uno de los procesos desde una escuela de ingeniería. Lo peor que puede suceder al probar un proceso es que la técnica no cure la enfermedad, pero es IMPOSIBLE que se lastime o electrocute al paciente con un generador(TENS) que usa una pila de 9 volts; la silla eléctrica aplicaba 2,000 volts. Antes de leer cualquiera de los tratamientos debe conocer acerca del TENS(Transcutaneous Electrical Neuro Stimulator) el cual es equivalente a la medicina, y ver sus características leyendo el archivo correspondiente contenido en este mismo paquete, y comprarlo por medio de internet, sólo teniendo cuidado que dentro de los “Modos de estimulación” contenga la opción: “Normal o Constante” . En caso de no lograr una cura por este tratamiento debe ver a su médico tratante.*

“ ESTA ENFERMEDAD PUEDE CURARSE CON EL TRATAMIENTO PARA ENFERMEDADES AUTO INMUNE EN PRIMERA INSTANCIA, Y SÓLO SI ESTE NO FUNCIONARA APLICAR ESTE”

INTRODUCCIÓN.

DIABETES MELLITUS TIPO I .

El tratamiento del páncreas se hace con objeto de que al estimularse se haga lo

mismo con el sistema inmune y este genere la formación de nuevas células beta productoras de insulina que son la causa de esta enfermedad.. Tiene mayor sentido estimular el páncreas en este tipo de diabetes que en la de tipo II, ya que en ésta si hay producción de insulina. Para lograr este propósito nos apoyaremos en la propiedad fundamental de la corriente eléctrica de recuperar el funcionamiento normal de un órgano al pasar corriente a través de él. No es clara la explicación médica acerca de que el páncreas sea el responsable de la enfermedad en el caso de la diabetes mellitus II, pues en este caso los pacientes sí producen insulina y las células del cuerpo sí absorben la glucosa para su nutrición, de otra forma morirían.

DIABETES MELLITUS TIPO I I.

El siguiente tratamiento se diseñó bajo la hipótesis de que ésta enfermedad es causada por un mal funcionamiento del órgano graso, el cual, cuando está sano, funciona las 24 horas del día captando cada molécula de glucosa de exceso en sangre transformándola en un adiposito o célula con una gota de grasa en ella y depositándola en el tejido graso situado bajo la piel y alrededor de los distintos órganos del cuerpo. Por otra parte, cuando el cuerpo no obtiene la cantidad de glucosa que requiere, el órgano graso toma la necesaria de ese almacén y la coloca en el torrente sanguíneo para su uso. Como se sabe también, el hipotálamo controla el funcionamiento del órgano graso, y mientras éste funcione bien no habrá exceso de glucosa en el torrente sanguíneo, que es la definición de diabetes. En conclusión, un buen funcionamiento del hipotálamo mantendrá un buen funcionamiento del órgano graso, y éste controlará todo exceso de glucosa en sangre evitando la diabetes.

Este ha sido uno de los proyectos más difíciles de configurar y plantear una solución eléctrica del mismo, pasando de tener un culpable inicial natural en el páncreas, al de llevar toda la responsabilidad hacia el órgano graso y posteriormente al hipotálamo, momento en el cual se paró la investigación o quedó latente el proyecto por la dificultad que involucraba acceder al cerebro; hasta que logré penetrarlo de manera segura y tener la posibilidad de poder estimular el hipotálamo en este diseño. El tratamiento deberá comprobarse en casa midiendo el nivel de glucosa en sangre y, posteriormente, un par de semanas después, con un estudio más preciso en un laboratorio.

PRIMERA SEMANA - DIABETES MELLITUS TIPO I y II.

Estimulación del páncreas

Esta parte se hace con el fin de ser integral y tomar en cuenta todas las posibles causas de enfermedad, varios anuncios en comerciales de televisión e internet señalan a una posible bacteria, tanto en el intestino como en el páncreas, como la causante de la diabetes, unos como devoradora de la insulina y evitando que llegue a todo el cuerpo, otros diciendo que la bacteria se aloja en el páncreas destruyendo y evitando se genera la insulina necesaria; cualquiera que sea la causa, la energía eléctrica, además de estimular el sistema inmune, es un antibiótico de amplio espectro y puede eliminar la bacteria en cuestión.

TRATAMIENTO

La figura 1 ilustra claramente cual debe ser la posición de ambos pads para lograr este propósito: ***“En el lado izquierdo un pad debe colocarse en el espacio comprendido entre la tercera y cuarta costilla iniciando de abajo hacia arriba; el otro pad, en el lado derecho del cuerpo, debe ir debajo de la última costilla. Además, ambos pads deben ir de la mitad del grosor del abdomen hacia la espalda dado que el páncreas esta atrás del intestino y estómago, más cercano a la espalda que al ombligo . Con este tratamiento se eliminará también a la posible bacteri a en él”***

TAMAÑO DE PADS. De preferencia usar pads rectangulares de 5 x 10 ó 4 x 8 centímetros colocados

TIEMPO DE TRATAMIENTO - 15 MINUTOS

INTENSIDAD DE CORRIENTE . De manera similar a casi en todos los procedimientos, ir aumentando la intensidad de corriente hasta percibirla, bajar muy ligeramente ésta , hasta dejar de sentirla y continuar en esa posición o intensidad todo el tiempo de tratamiento.


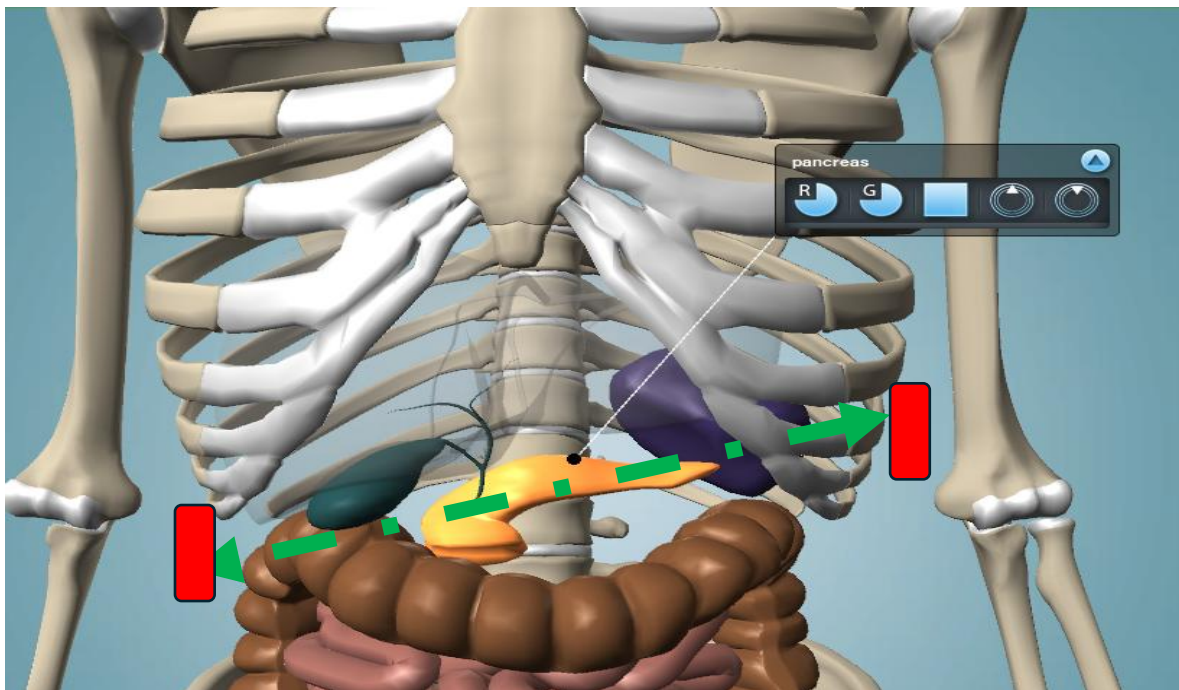


Figura 1. Posición del páncreas y pads de estimulación. Tiempo de tratamiento 10 minutos.


SEGUNDA SEMANA: DIABETES MELLITUS TIPO II .

Estimulación del hipotálamo .


1. POSICIÓN DEL HIPOTÁLAMO

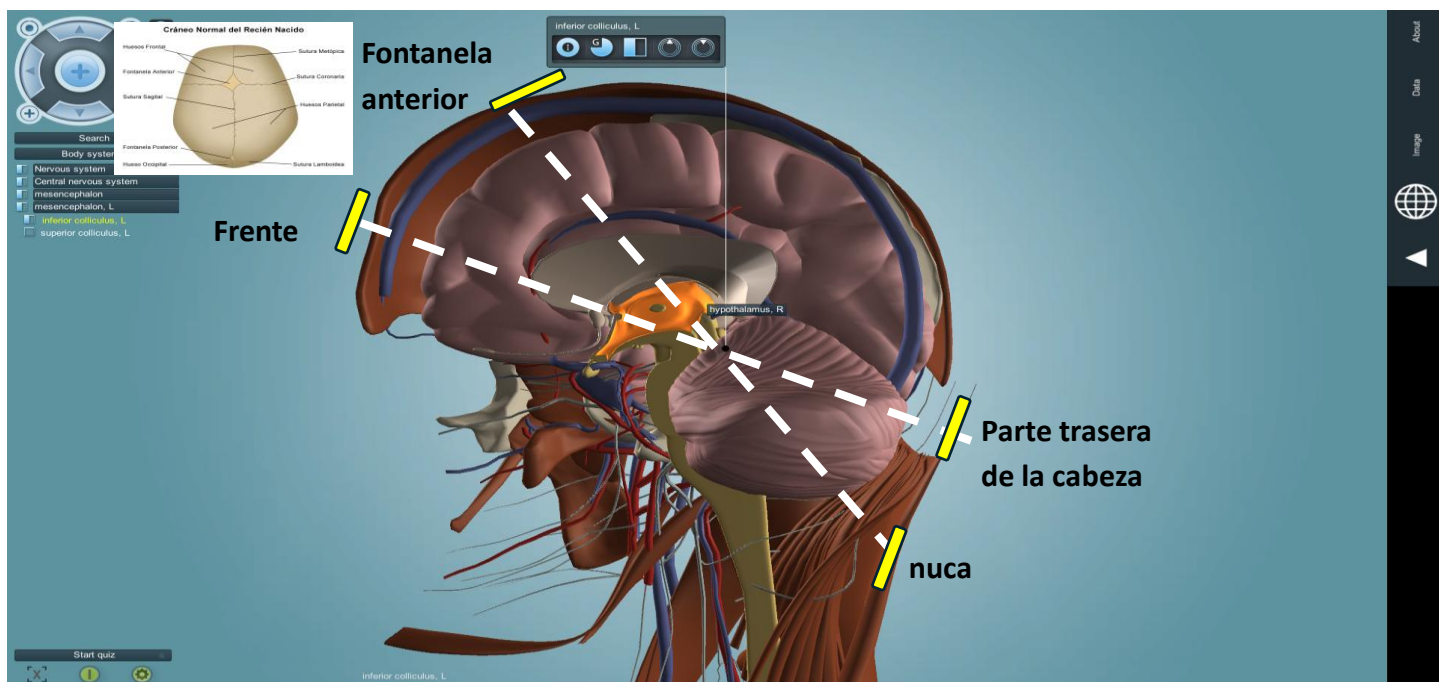

(a)

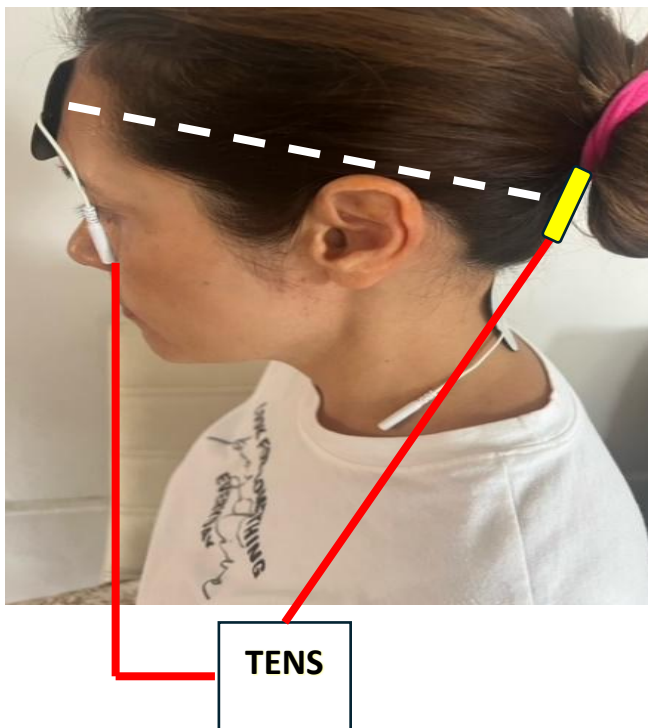

(b)

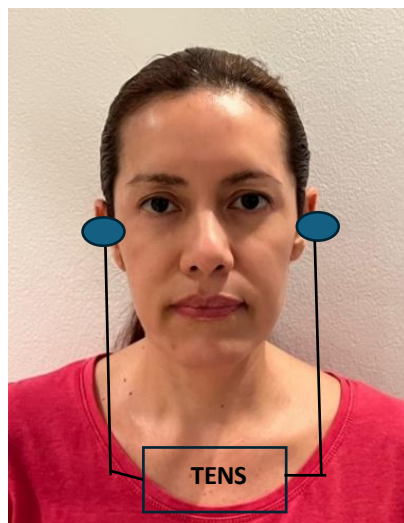

(c)

Figura 2.a. Posición del hipotálamo; (b) . Posición de páds para el tratamiento.(c) Estimulación entre ambos oídos. Tiempo de tratamiento 5 minutos por posición.

ESTIMULACIÓN USANDO PARTE SUPERIOR DE LA CABEZA, FRENTE Y NUCA .

Parámetros de tratamiento según tipos de diseño:

Tiempo y posición de pads.

- Estimulación entre frente y parte posterior de la cabeza – 10 minutos de tratamiento. – Figura 2a.
- Estimulación entre fontanela y nuca - 5 minutos. Figura 2b .
- © Entre ambos oídos – 5 minutos. Figura 2c .

NOTA. Se debe humedecer el pelo a fin de permitir el paso de la corriente, presionar el pad para eliminar el dolor y favorecer el paso de la corriente.

TAMAÑO DE PADS:

Cuadrados de 5 x 5 cm , rectangulares de 5 x 10 cm y circulares de 2 ó 3 cm; para el páncreas es conveniente el tipo rectangular de pads, de 5 x 10 ó 4 x 8 centímetros, 4 pads de este tipo.

TIEMPO TOTAL DEL TRATAMIENTO. El proceso global tarda dos semanas de lunes a viernes o 10 días continuos, dependiendo del avance, de los noveles de glucosa detectados, principalmente, se podrá continuar una semana adicional en cada una de las enfermedades para curarla totalmente.

“Vale la pena hacer notar que el proceso de restablecimiento del órgano continúa aún después de terminar el tratamiento”.

INTENSIDAD DE CORRIENTE . De manera similar a casi en todos los procedimientos, ir aumentando la intensidad de corriente hasta percibirla, bajar muy

ligeramente ésta , hasta dejar de sentirla y continuar en esa posición o intensidad todo el tiempo de tratamiento.

TERCERA SEMANA: ELIMINACIÓN DE BACTERIA PRODUCTORA DE LA ENFERMEDAD EN EL INTESTINO .

Debido a la frecuencia cada vez mayor de anuncios acerca de que el vinagre de manzana elimina una bacteria en el intestino que consume toda la insulina producida por el páncreas provocando la diabetes, aún cuando sólo es un producto comercial, se anexa una técnica para eliminar dicha bacteria en un solo tratamiento usando la propiedad de la energía eléctrica de ser un antibiótico de amplio espectro. De esta forma se da un tratamiento integral que va por fases, y se podrá ver en cual de ellas efectivamente cura una enfermedad tan terrible como la diabetes con más de 830 millones de personas enfermas en el mundo, y cancelar el resto .


TRATAMIENTO

Tiempo de tratamiento: 10 minutos por posición.


Tamaño de pads: Usar pads de 5 x 10 ó 4 x 8 centímetros.

Intensidad de corriente : De manera similar a casi en todos los procedimientos, ir aumentando la intensidad de corriente hasta percibirla, dejarla en esa intensidad, y continuar así todo el tiempo de tratamiento.

Frecuencia de tratamiento. Como en todos los casos de tratamiento usando un **TENS**, la frecuencia siempre debe de fijarse en la máxima que puede dar éste, que es de 150 hertz.

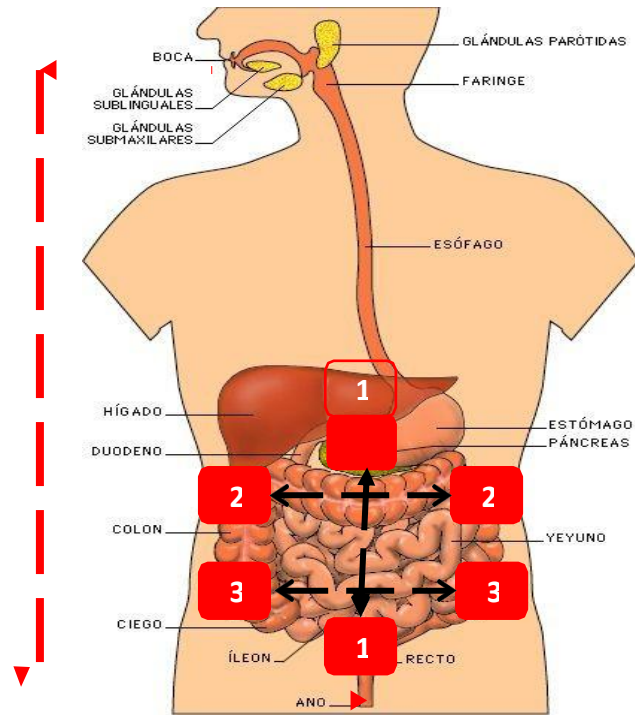

(a)

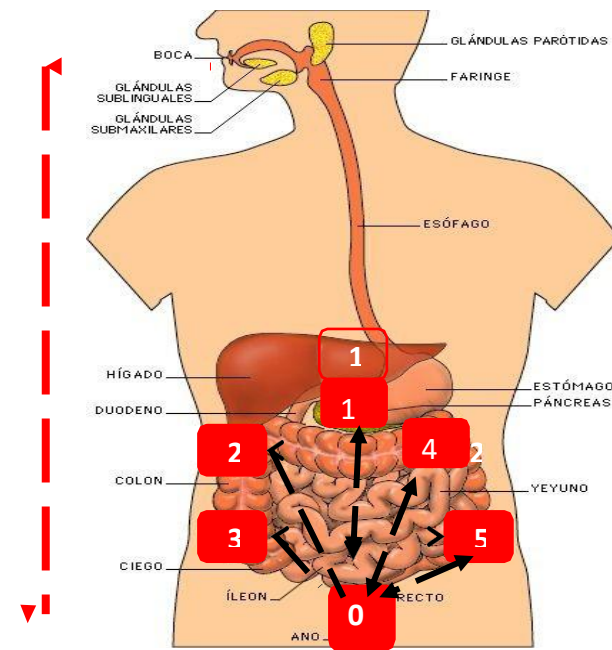

(b)

Figura 3a. Tratamiento del intestino ; la corriente va de un pad al otro . Las posiciones 1,2,3 van pegadas al abdomen y lo barren en forma vertical y horizontal; (b) El pad 0 va en la boca del ano y sólo se mueve el otro irradiando todo el abdomen desde la posición 1 hasta la 4; en este caso la corriente va por dentro del intestino, este diseño es mucho más eficaz que el primero(a).